


Die Vervielfältigung, Übertragung oder Gebrauch dieses Dokumentes ist ohne explizite schriftliche Genehmigung nicht autorisiert. Zuwiderhandlungen sind haftbar für verursachte Schäden. Alle Rechte, einschließlich erteilter Patente, eingetragene Markenzeichen oder Gebrauchsmuster, sind vorbehalten.

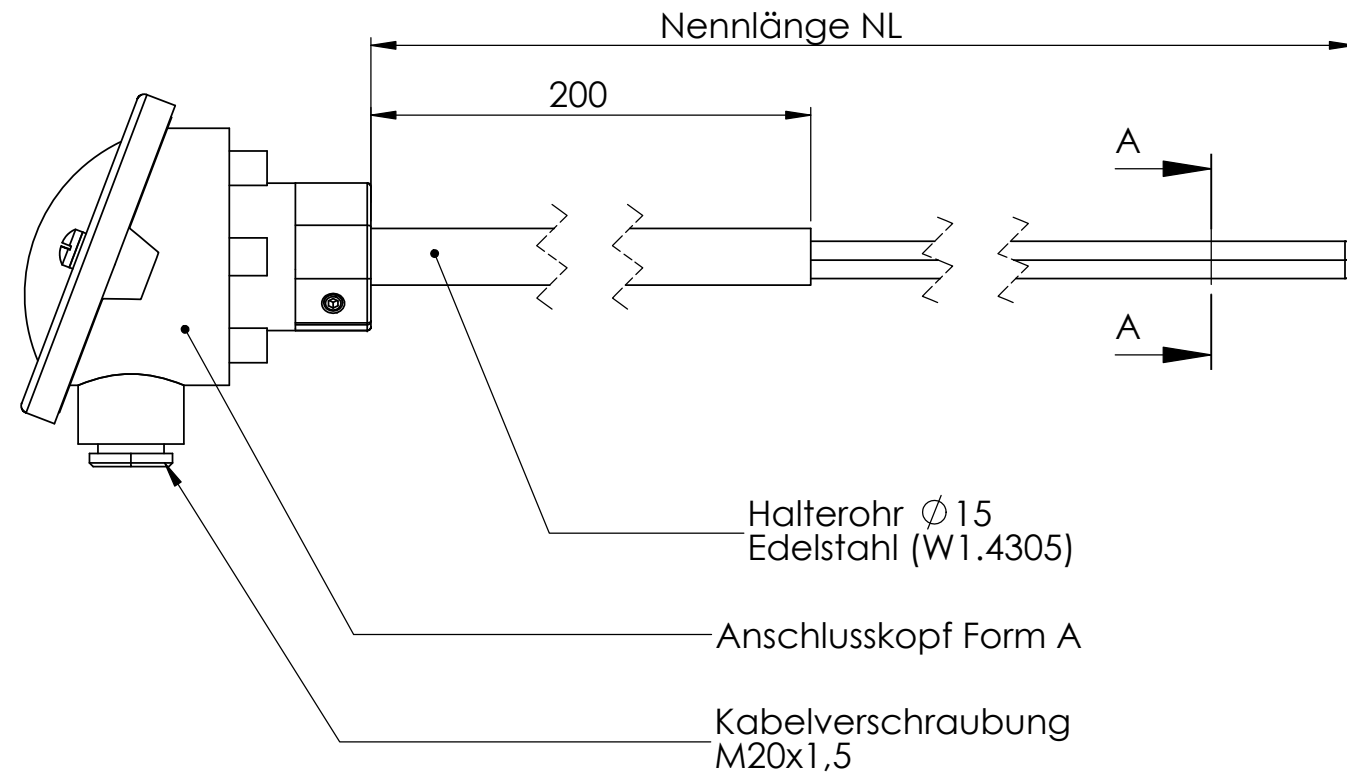


keramische Lüsterklemme
Thermopaar 1

keramische Lüsterklemme
Thermopaar 2

Zugang zu
leeres Prüfrohr

Montageplatte
Al



PtRh10%
Pt pure
Kapillarrohr
99.7% Al₂O₃

SCHNITT A-A
MAßSTAB 5 : 1

min. ϕ 12
für Durchführung

Leeres Schutzrohr
für Insitu Prüfmessungen

Thermopaare: Typ S DIN EN 60584-1, Klasse 1

Kalibrierzertifikat

basierend auf Fixpunktmessung Gold und Palladium
Korrekturwerte 500°C bis 1500°C in 100K Schritten
andere Messpunkte auf Anfrage
Kalibrierung nach AMS 2750 auf Anfrage

* Verschraubung muss
separat bestellt werden!

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:		OBERFLÄCHENGÜTE:		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG	
						thermo-control Körtvélyessy GmbH		www.thermo-control.com Tel: +49(0)3040586940	
						BENENNUNG: Schutzgas-Thermoelement			
						ZEICHNUNGSNR. 13-0103-SR15		A3	
						MASSTAB:1:2		BLATT 1 VON 1	

The reproduction, transmitting or use of this document is not permitted without the express written authority. Offenders are liable for damages. All rights created by patent grant, registered trademarks or a utility model or design, are reserved.