


Anschlusskopf DIN43729 Form A



R 3/4"

L

A

A

M20x1.5 Kabelverschraubung

Leerrohr

Minimum \varnothing 12
für Ofen-
Durchführung

negativer Messdraht

positiver Messdraht


Schutzrohr \varnothing 5

Kapillar \varnothing 2.5

Leerrohr für Prüfthermoelement

Schnitt A - A 5:1

Anschlussklemme

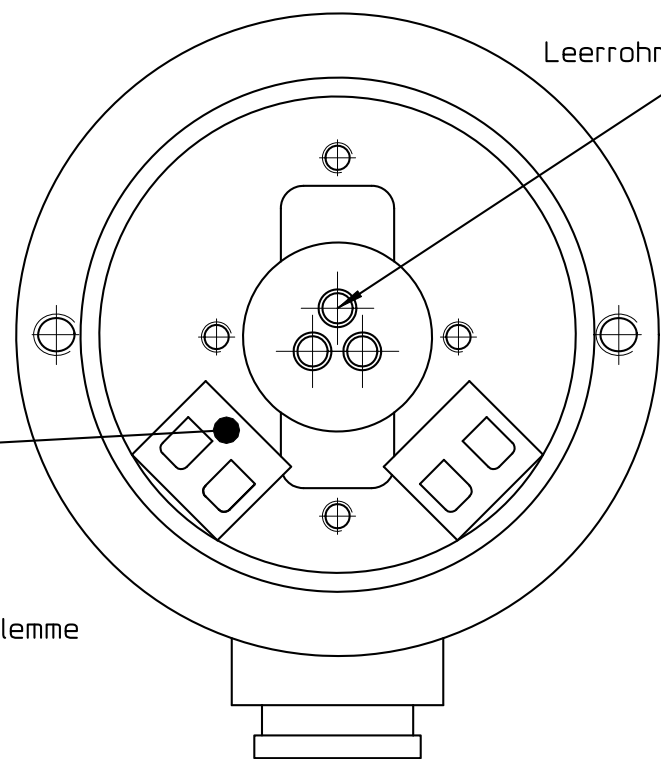

Länge L [mm] Length L [mm]							
400	1400						
450	1500					Baufeilbezeichnung : Component name :	
500						Dreifach - Thermoelement	
550		A	Erstellung	2008-03-06	KOR	Spezifikation : Specification :	
600		Zust.	Änderung	Datum	Name	Revision : Revision : A	
700		Werkstoff : Material : Stückliste 8-0103-R34				Zeichnungs - Nr. : Drawing - No. :	
800		Gewicht : Weigh :				13-0103-R34	
900		Hinweis / Notice				Ers.f	
1000		Die Vervielfältigung, Übertragung oder Gebrauch dieses Dokumentes ist ohne explizierter schriftlicher Genehmigung nicht autorisiert. Zuwiderhandelnde sind haftbar für verursachten Schaden. Alle Rechte, einschließlicherteilte Patente, eingetragene Markenzeichen oder Gebrauchsmuster, sind vorbehalten.				Ers.d	
1100		The reproduction, transmission or use of this document is not permitted without the express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights, including right created by patent grant or registered trademarks or an utility model or design, are reserved.					
1200							
1300							